


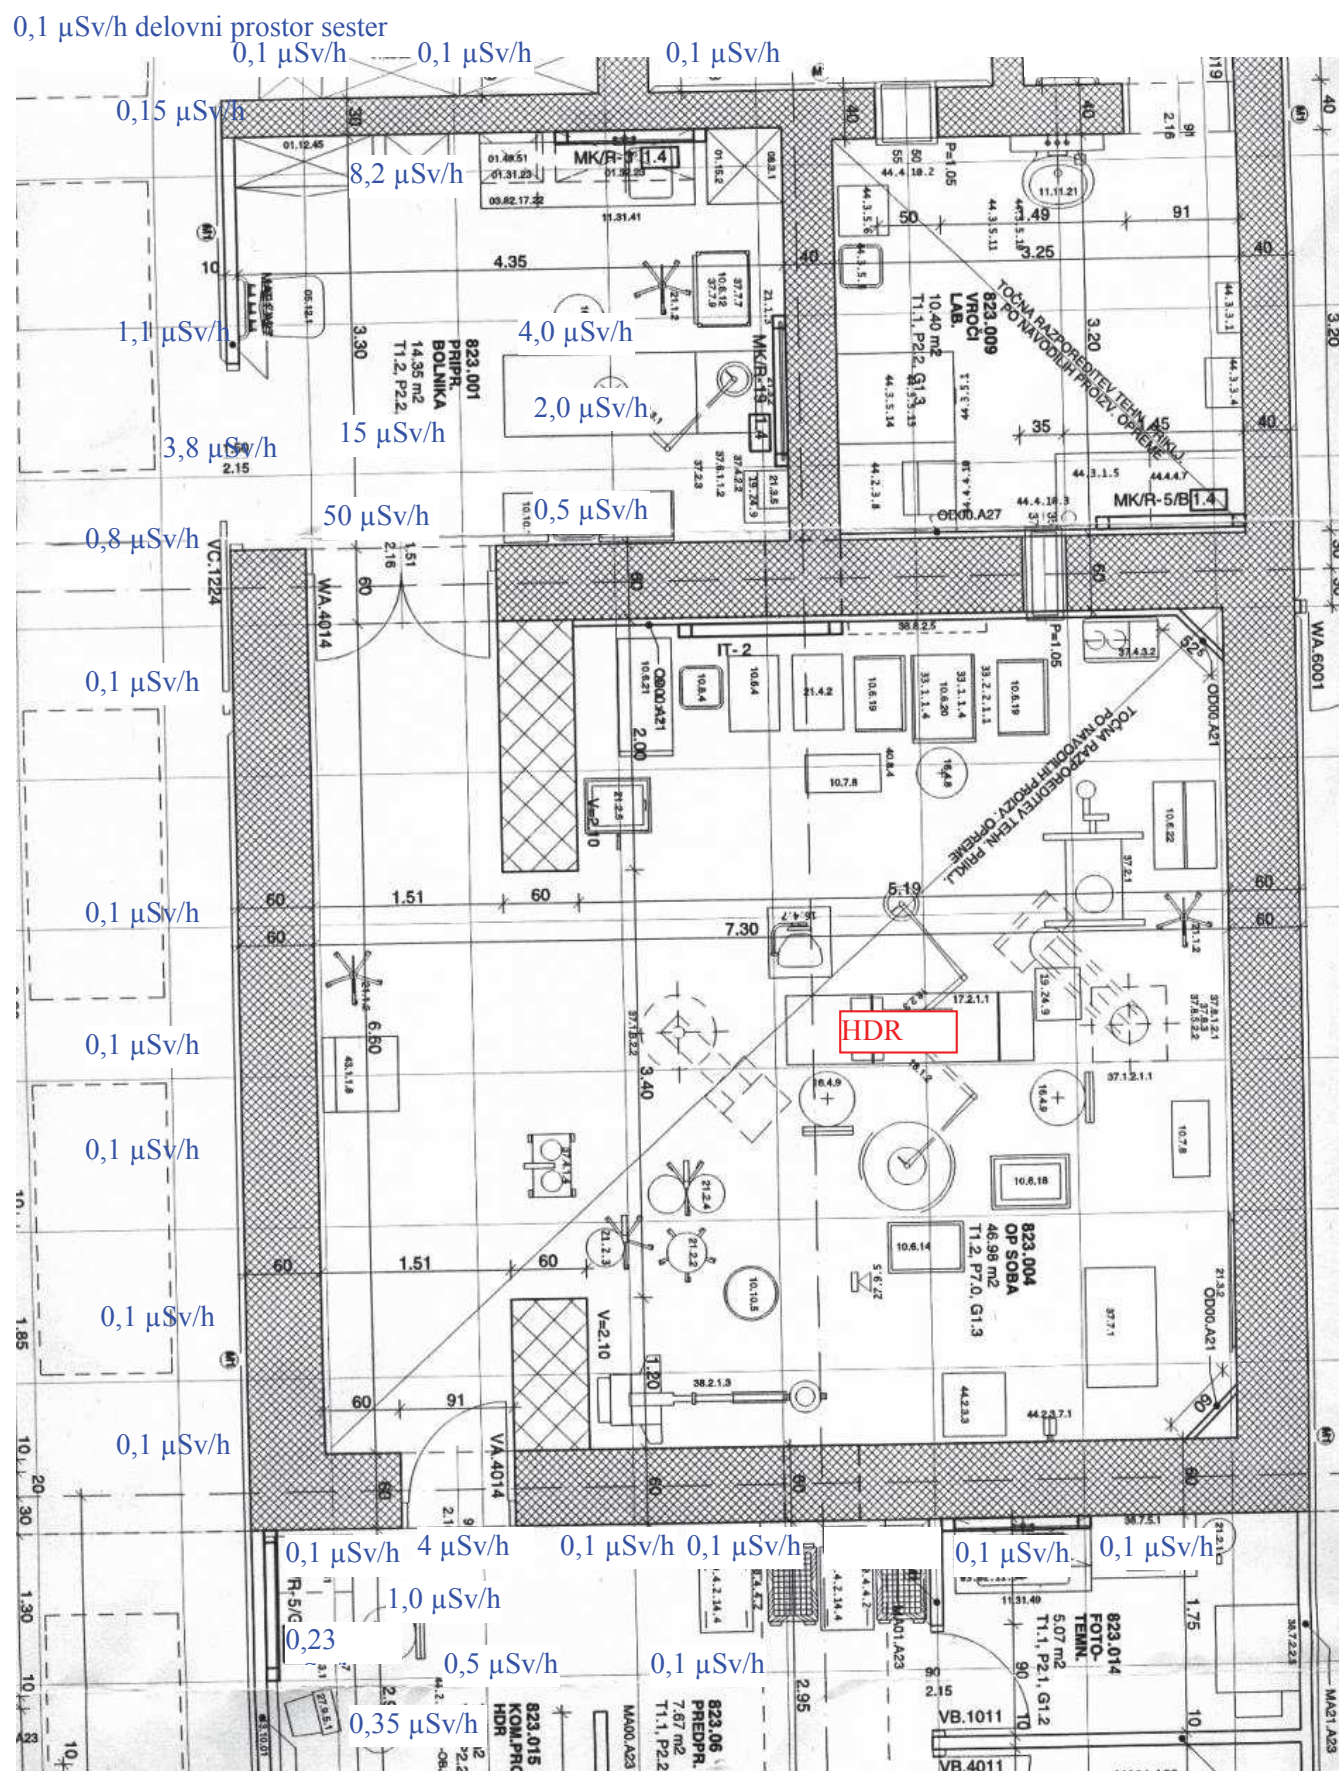

Slika 5: Meritve hitrosti doz v okolici prostora z napravo Gamammed. Rdeče je označen položaj HDR naprave med izvajanjem meritev. Skica je shematska.